


V. A U T O C A L (自動校正器)

概要 分析計からの出力 (4 ~ 20mA又は0 ~ 1V) を受け、値を定期的に標準ガスによって補正し、出力します。校正周期はタイマーにより任意設定出来ます。弊社O₂計の他、あらゆるガス分析計に使用出来ます。
※本装置は元のO₂計の指示、出力を校正するものではありません。


A U T O C A L仕様

取	付	壁掛式
入	力	D.C. 4 ~ 20mA又は0 ~ 1V
出	力	同上
調	整	範囲
		ゼロ側 : 4 ~ 8mA or 0 ~ 250mV
		スパン側 : 14 ~ 20mA or 625 ~ 1000mV
校	正	周期
		999時間 Max.
警	報	校正不良 (A接点)


A U T O C A L外形図

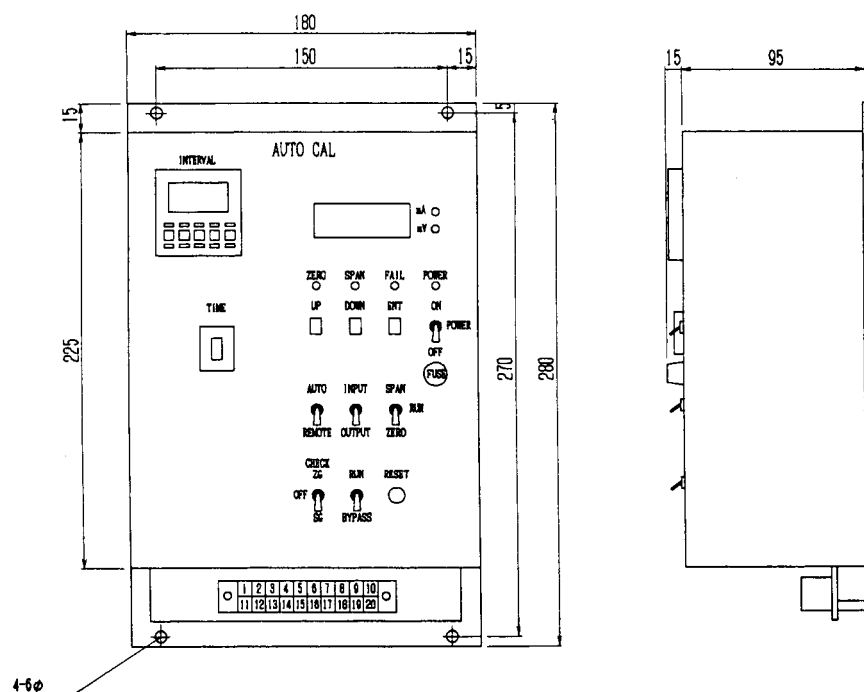


A U T O C A L端子台図

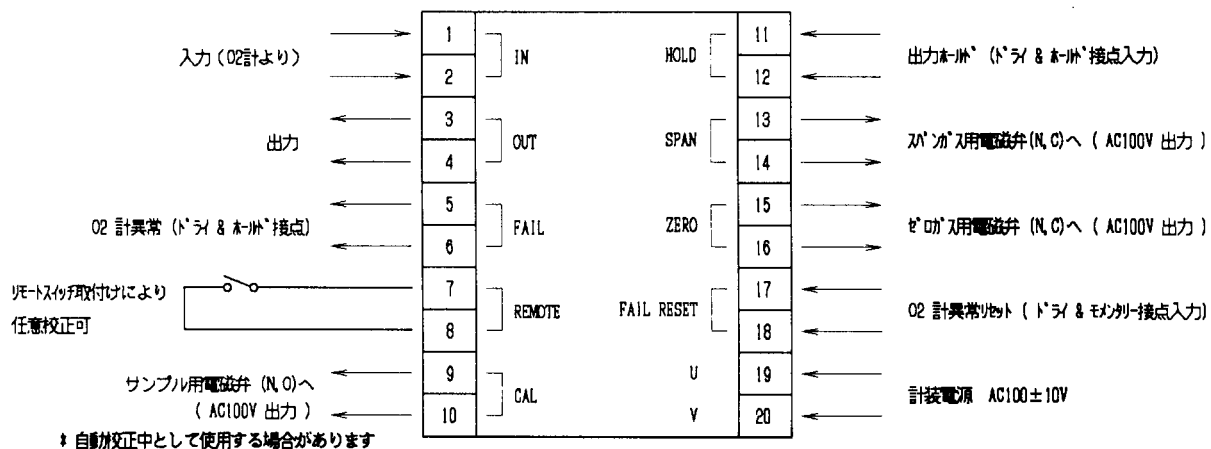

AUTO CAL参考フローシート 1

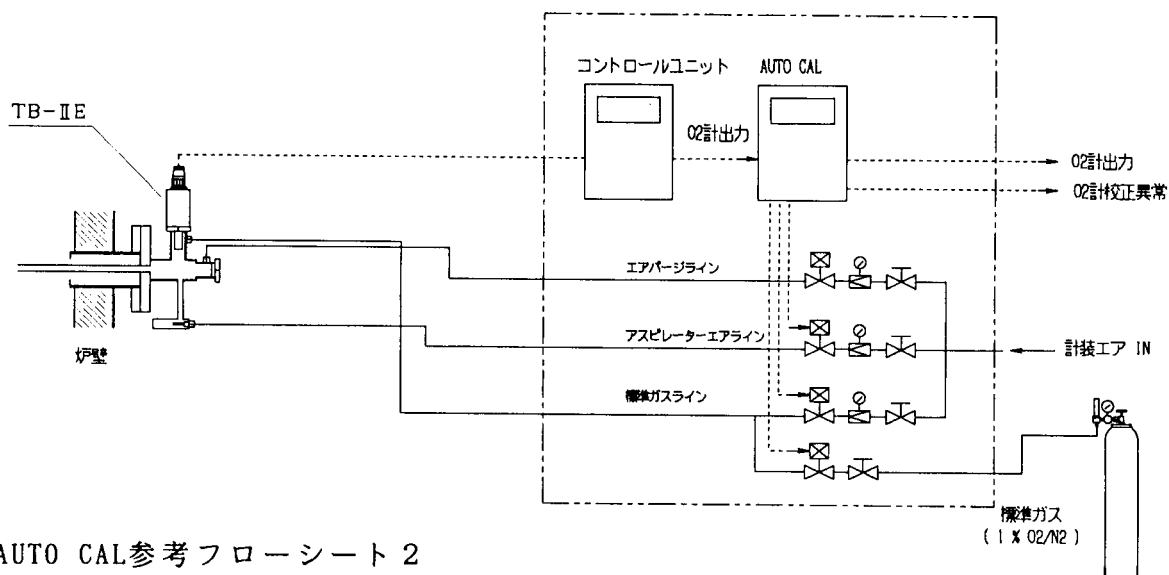

AUTO CAL参考フローシート 2

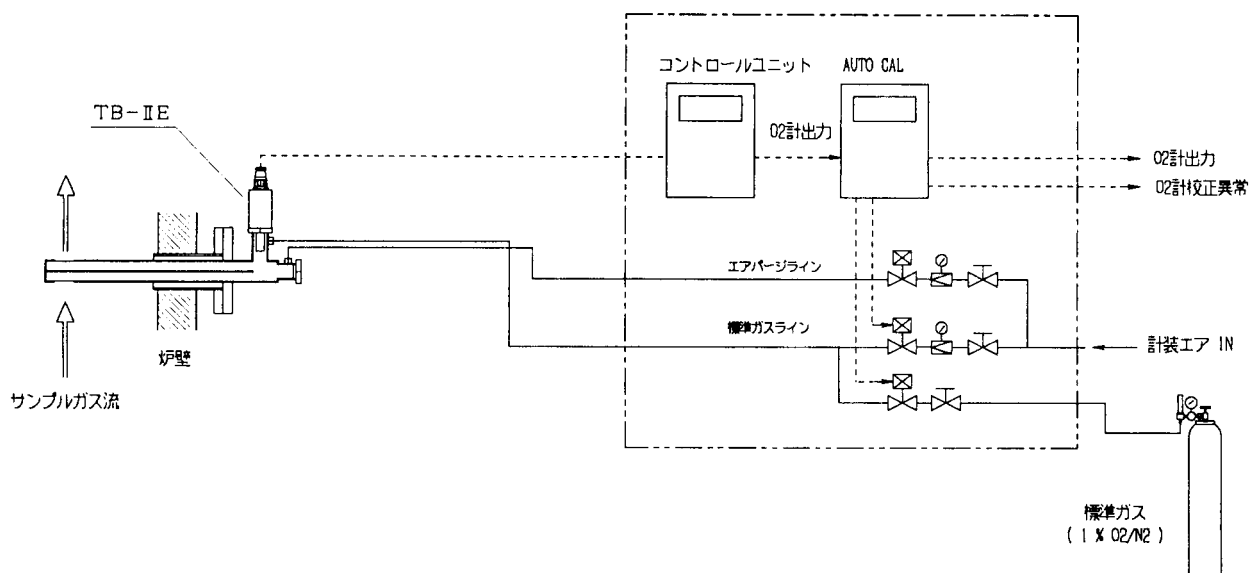

AUTO CAL参考フローシート 3

